

Manuel d'utilisation


EO

INSTRUMENTS

A FLIR COMPANY

Modèle 380260

Testeur d'isolation/Mégohmmètre

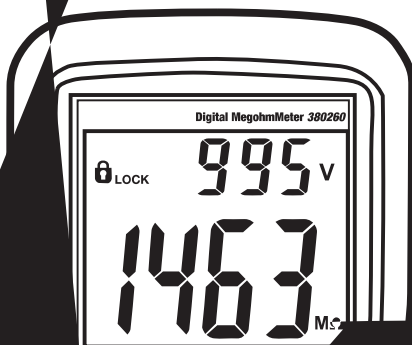



Fonctionnement

Avertissement

Branchement des fils d'essai

Ω

Vérification des fils d'essai



Ω

Mesures de la résistance d'isolation (Tests du mégohmmètre)

Attention :

Ω

Ω



Fonction de verrouillage



Remarques sur les tests IR (Mégohmmètre) :

Ω

Mesure de la tension AC/DC

Ω

Mesure de la résistance

AVERTISSEMENT

Ω

Ω

Mesure de faible résistance (Continuité)

Ω 

Ω

Ω

Mise hors tension automatique

Fonction HOLD (Maintien des données)

Rétro-éclairage





Caractéris

écifications

AMMES DU M

RE

G
Ω
Ω
Ω
Ω

Gam a

Ω
Ω
Ω

ENSIC

RESUME

	Résolution	cision	ren	protection contre les surcharges
Ω	Ω		ouvert	
Ω	Ω			


Spécifications générales

<40 Ω

CE

Entretien

Remplacement des piles

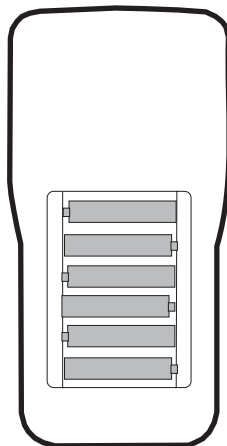

Ordonnance relative à
il est interdit



l'élimination des piles usagées
de les jeter avec les ordures ménagères !

Mise au rebut :

Nettoyage